クリアフィル® クラブ

クリアフィル® クラブ 通信 Vol.4

「クリアフィル® SA ルーティング」について

Q1 ペーストの一歯あたりの使用量はどのくらいですか。

A 一歯あたりの使用量の目安としてはクラウンでは約5ミリ、インレーでは約2.5ミリを目安にご使用ください。また、このたび目盛り付き練和紙を発売いたしました。5ミリ刻みの目盛りがついておりますので、ぜひご利用ください。

これで解決！

［目盛りつき練和紙］
●#915
●目盛りつき練和紙
●50枚綴り/59mm×83mm

Q2 ペーストが先端で硬化してしまって、採取できません。

キャップを閉める際に向きを間違えた場合などに、Aペースト・Bペーストが接触し、シリンジ先端部のペーストが固化することがありますので、シリンジの先端がペーストで汚れた場合は乾いたガーゼ等で拭き取ってからキャップを締めてください。また、このようなキャップの逆閉めを防止する為に、シールの配布を行っております。送付をご希望の際は、お問い合わせ専用フリーダイヤルにてお申しつけください。
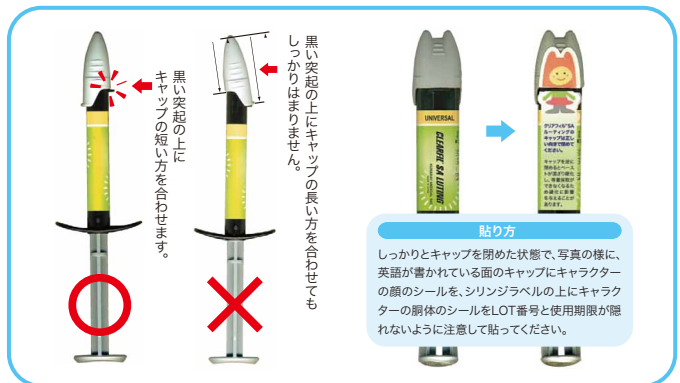
クリアフィル® SA ルーティング

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号：219ABBZX00311000

【バリューキット】［ユニバーサル］
・Aペースト 4.4g(2.5mL) ・Bペースト 4.2g(2.5mL) 3本
付属品／練和棒、練和紙 各1個

【ペースト単品】
・Aペースト 4.4g(2.5mL) ・Bペースト 4.2g(2.5mL) 1本

● ご使用に際しましては、必ず製品の添付文書及び取扱説明書をお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28 〒959-2653 www.kuraraynoritake.jp

販売 株式会社モリタ
大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161

10/2012